




Medline International France SAS

Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel : 01 30 05 34 00
Fax : 01 30 05 34 52

www.medline.com/fr

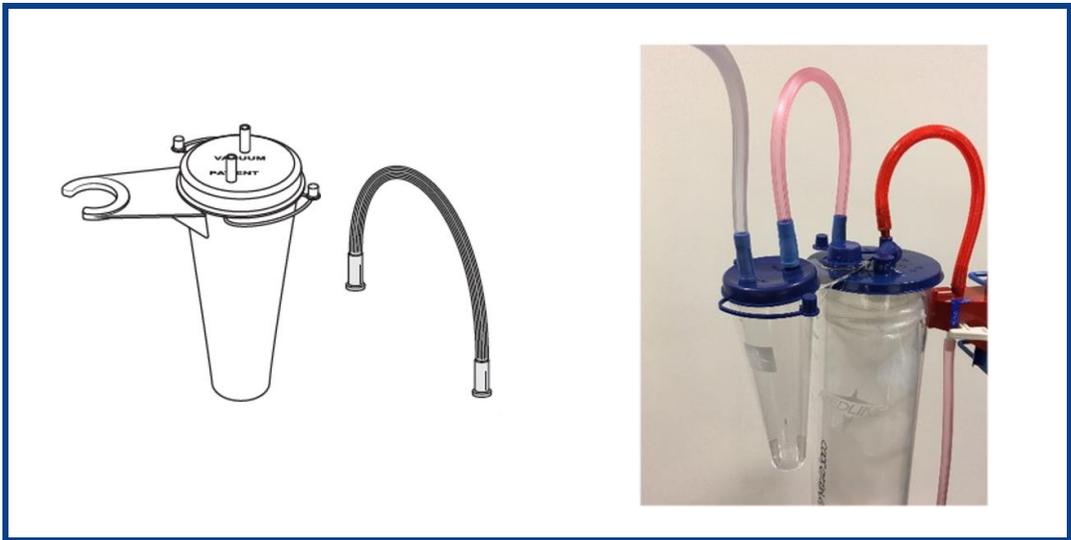

Fiche technique

Bocal pédiatrique (300 ml)

Référence

OR300PEDA


Description

Le système se compose :

- A. D'une partie rigide transparente graduée permettant une lecture très précise du volume des liquides aspirés (graduation de 5 ml en 5 ml)
- B. D'un couvercle muni d'un site Patient et d'un site Vide
- C. D'une tubulure de connexion
- D. D'une connexion pour fixer le bocal sur le site accessoire de la poche MEDSOFT (E)

La tubulure de connexion (C) relie le site "vacuum" du bocal pédiatrique OR300PEDA au site "patient" de la poche d'aspiration (E). La tubulure patient (F) est connectée au site Patient du bocal pédiatrique OR300PEDA.

Le bocal pédiatrique est compatible avec les systèmes d'aspiration Medline suivants : MED-SOFT, MED-RIGID et MED-SEMIRIGID

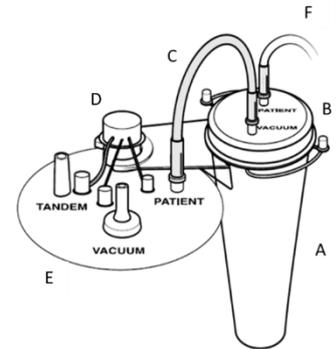

Composition

Bocal : Polystyrène; Couvercle: polyéthylène; Tubulure: PVC avec DEHP

Stérilisation

Produit non stérile

Conditionnement

30 unités par carton (1 unité = 1 bocal, 1 couvercle et 1 tubulure de connexion)

Fabricant

Medline Industries, Inc.
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la directive 93/42/CEE.
MDD Class I – Non stérile

